

### **Обратите внимание!**

Во избежание повреждения стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставлять.

Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног).

Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить фиксатор, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксатор.

### **Правила по эксплуатации мебели**

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

### **Уход за пластиковыми поверхностями**

1. Пластиковые поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### **Уход за полиуретаном**

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

### **Условия гарантии**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)

## **ПАСПОРТ**

### **Руководство по сборке и эксплуатации**

### **Кресло медицинское для лечебных учреждений KP11-B Кресло медицинское для лечебных учреждений KP11-B/П**

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497 от 01.06.2021

### **Назначение и описание изделия**

Кресло KP11 и KP11-B/П на газ лифте предназначено для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас пластиковый черного цвета, оснащён регулируемым по высоте кольцом – опорой для ног диаметром 460 мм. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 600 мм.

Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 560 мм до 800 мм. Высота кресла – от 980 мм до 1220 мм.

Сиденье и спинка из полиуретана. Размер сиденья – 460x420 мм, размер спинки – 400x300 мм.

Кресло KP11-B/П комплектуется двумя подлокотниками из полиуретана. Размер подлокотника 220x90x30 мм. Высота от верха сиденья до верха подлокотника регулируется от 210 до 280 мм. Расстояние между подлокотниками 490 мм.

Вес изделия: KP11-B – 11 кг, KP11-B/П – 13,5 кг.

Упаковка кресла – картонная коробка. Габаритные размеры упаковки: 600x570x250 мм. Вес – 12 кг. Объем – 0,09 м<sup>3</sup>.

Подлокотники упаковываются отдельно. Размер упаковки: 130x150x300 мм. Вес – 3 кг. Объем – 0,006 м<sup>3</sup>.

### **Комплектация и инструкция по сборке**

Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.



Спинка




Сиденье



Крышка



Механизм



Основание



Колесо



X5


Газ лифт



Колесо -  
опора для ног




Деталь спинки




Крепежные изделия

S1 X4 M6x25	
S2 X2 M6x30	
S3 X4 M8x18x10mm	
S4 X4 M6x16x1.2	
S5 X1 M5	


1

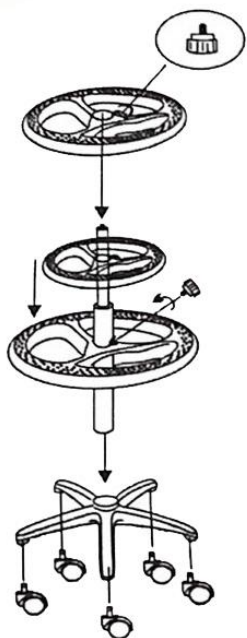

2

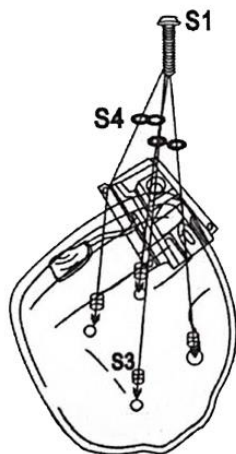

3

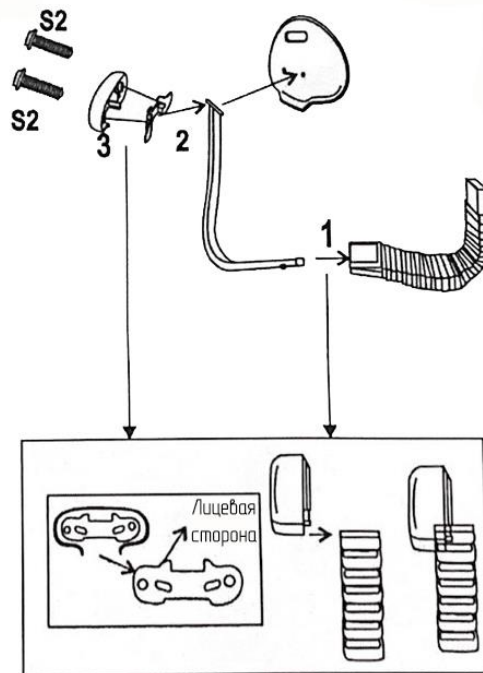

4

